
Hjælp til Skift af infusionssæt 780G

Pumpens knapper:



Tryk på den hvide knap i midten (vælg/OK) for at komme til menu

Gå i sprøjte og sæt

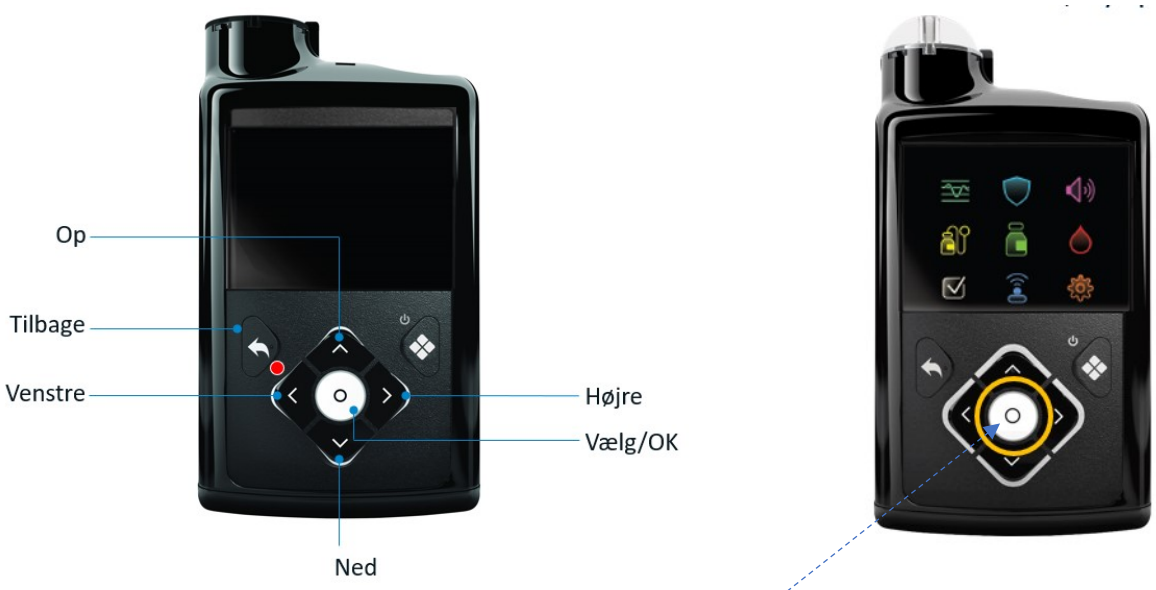

Hvordan skiftes sprøjte (reservoir) og sæt:


- Se gerne den tilsendte video igennem inden du skifter sæt, de første par gange https://www.youtube.com/watch?v=WjRsFaby5vI&list=PLzEjwVmus0gG23P3aAD6TPbd7LGf1dY8m&index=13

- Læg alt udstyr til skift klar på bordet foran dig (sprøjte/reservoir, infusionssæt, inserter til infusionssæt, insulin i hætteglas, sprit serviet)
- I pumpens menu vælger du "sprøjte og sæt" – tryk "ok"
- Tryk derefter på "Ny sprøjte" – tryk "ok"
- Følg instruktionerne på pumpeskærmen
- Fjern det gamle infusionssæt fra kroppen – når det er gjort trykkes "næste"
- Fjern det gamle reservoir fra pumpen ved at dreje det mod uret. Kassér det brugte udstyr
- Følg instruktionen på skærmen – tilbagestil pumpen

Hjælp til Skift af infusionssæt 780G

- Nu skal sprøjte/reservoir fyldes med insulin fra hætteglas (se evt. video). Fyld først sprøjten med luft svarende til 3 dages insulinbehov. Lad glasset stå på bordet mens du med et fast greb sprøjter luften i hætteglasset. Derefter holder du fast på stemplet og vender hætteglasset, så insulin flyder ned i reservoiret. Træk stemplet tilbage til der er insulin nok til ca 3 dage (3 ml = 300 enheder).



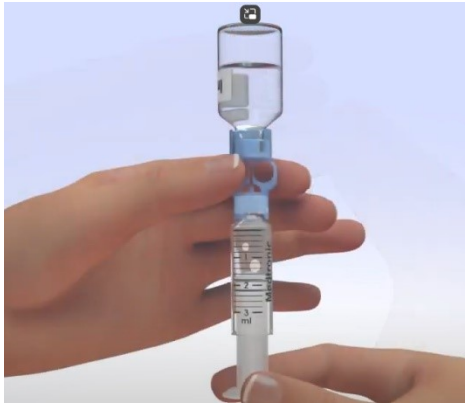


- Tjek at der ikke er luftbobler i det fyldte reservoir. Bank forsigtigt på sprøjten for at få luftbobler øverst, så de kan skubbes ud med stemplet. Tjek også den øverste del af reservoiret for bobler og skub dem ud, hvis der er nogle.



- Når alle bobler er væk stilles glasset igen på bordet og du fjerner det lyseblå stykke med nål fra reservoiret – og kassér nålen.
- Pak infusionssættet ud og sæt det sammen med reservoir (skrues forsigtigt på indtil der høres et klik). Tjek at reservoir og infusionssæt nu sidder fast sammen.


Hjælp til Skift af infusionssæt 780G

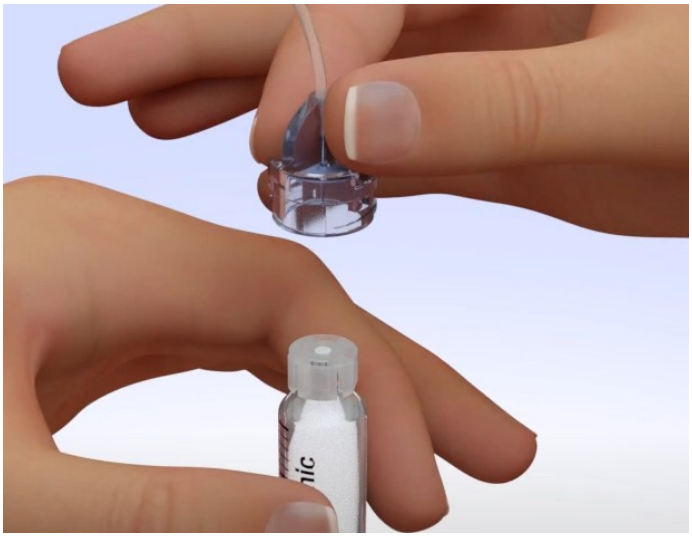


- Tjek igen for luftbobler i reservoir og fjern dem ved at trykke på stemplet



- Når du er sikker på at der ikke er flere luftbobler i reservoir, kan du fjerne stemplet ved at skrue mod uret.
- Placer reservoir i pumpen ved at skrue det med uret til det er låst fast (se billede af korrekt placering, når det er låst fast)

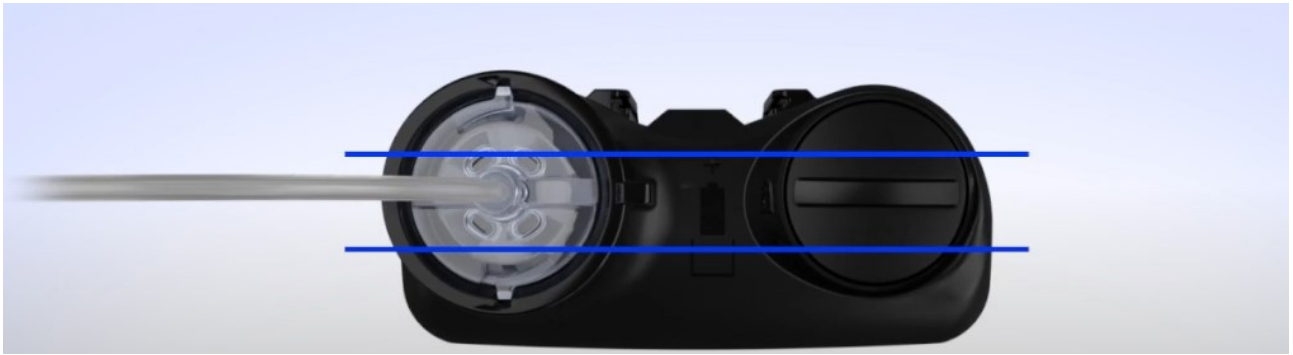

- Vend tilbage til pumpeskærmen. Hvis den er gået ud, imens du samlede sættet, trykker du på ”OK” og vælger igen ”sprøjte og sæt”.
- Følg skærmens anvisninger – hold ok knappen inde så stemplet i pumpen kører op og rammer reservoiret.
- **Tilslut ikke til kroppen endnu**! Først skal slangen fyldes. Følg skærmens instruktioner. Vælg ”fyld” og tryk på ”OK” (hold knappen nede), indtil du kan se at der kommer insulin ud af infusionssættets nål.

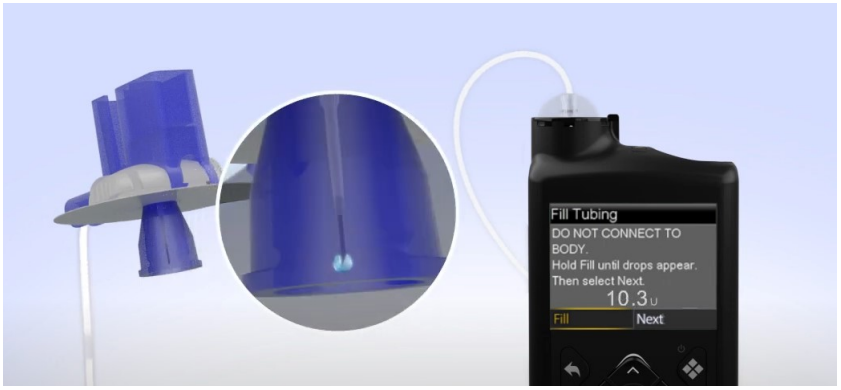

- **Husk:** Tjek at der ikke er luftbobler i slangen
- Når slangen er helt fyldt uden luftbobler tryk ”ok” og tryk ”næste”
- Nu skal du indstikke infusionssættet på maven.
- Sæt inserter på bordet med åbningen opad.
- Sæt infusionssættet i inserter, så det lille blå ”håndtag” passer med hullet i kanten. Tryk let med to fingre, så du sikrer at sættet sidder fast i inserter (se billede).




- Fjern plastrets bagsidebeskyttelse
- Gør inserter klar ved at trække tilbage i det grønne ”håndtag”. Fjern derefter den blå beskyttelseshætte fra nålen.

- Nu skal infusionssættet sættes på maven. Hold inserter fast ind mod huden og tryk samtidig på de 2 grønne knapper.

Hjælp til Skift af infusionssæt 780G




- Når sættet er ”skudt ind” trykkes på den grå pind/udløser i midten, som holdes inde imens du fjerne inserter og holder med den anden hånd på det lille blå stykke af infusionssættet.

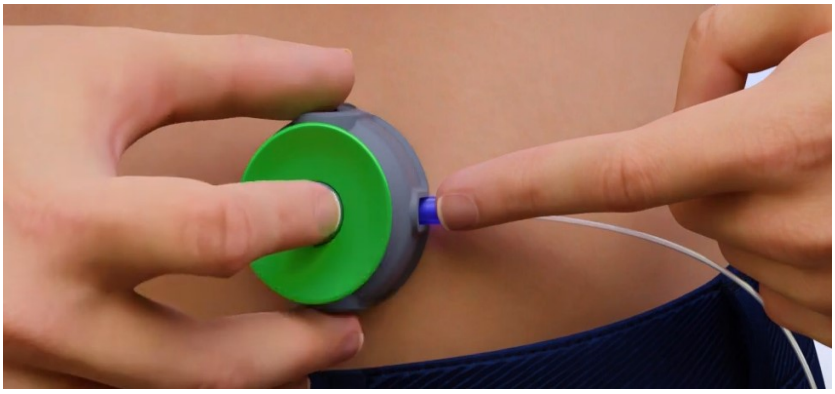

- Sørg for at plasteret sidder godt fast ved at stryge med en finger rundt langs kanten.

- Hold på infusionssættet med den ene hånd og fjern det blå plastik, hvor i nålen sidder med den anden hånd. Fold det sammen og kassér.

Hjælp til Skift af infusionssæt 780G

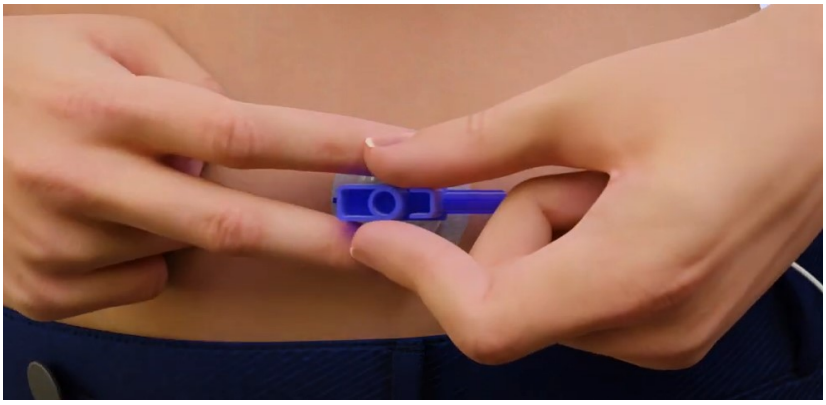

- Til sidst skal kanylen fyldes. Følg instruktionerne på skærmen. Kanylen skal fyldes med 0.5 enheder insulin. Det er allerede angivet i pumpen, så du trykker ”fyld nu”

Nu er du færdig med at skifte sprøjte og sæt. Godt klaret:-)

Det er en god idé at tjekke blodsukkeret ca 2 timer efter et sætskifte for at sikre at blodsukkeret ikke er steget meget, hvis blodsukkeret er steget højt op efter 2 timer kan det være tegn på at sættet ikke sidder korrekt.